


正誤表

このたびは『小児眼科学』をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

本書第1刷（2015年10月25日発行）のp.031「図2-26 パネルD-15テストの判定」において、「パス（pass）」と「フェイル（fail）1型色覚」の画像が入れ替わっている誤りがありましたので、ここに訂正し、謹んでお詫び申し上げます。

2016年2月22日 株式会社三輪書店

【誤】

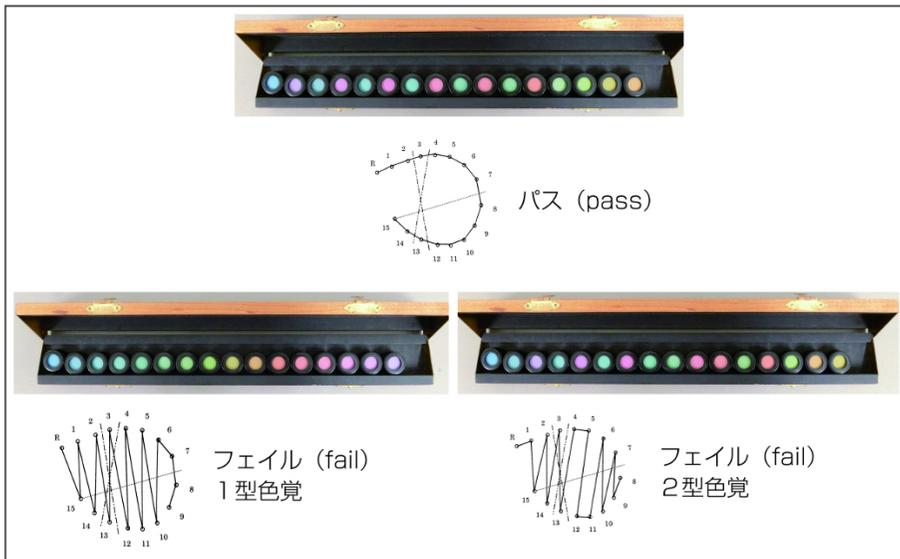

【正】

